

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -  
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

---

Sede Legale: P.le Cinelli - 6121 Pesaro  
Tel. 0721/36.6320 - Fax 0721/362470

**PROCEDURA APERTA**

**OGGETTO:** *Procedura aperta per l'affidamento di fornitura, installazione ed adeguamento di n.2 TC Multistrato per le attività di Diagnostica Radiologica della AORMN*

***Lotto 1 - CT Fano***

**VERBALE  
del 09/07/2018**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Vista e richiamata la determina n.291/DG del 30 maggio 2018 ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di fornitura, installazione ed adeguamento di n. 2 TC Multistrato di alta fascia e di ultima generazione per le attività di Diagnostica Radiologica della AORMN" e vista e richiamata la determina n.363/DG del 25 giugno 2018 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice come segue:

- Dr.ssa Anna Mensà, Dirigente Medico presso la UOC Diagnostica per Immagini dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Presidente);
- Dott.ssa Eleonora Belligotti, Dirigente Fisico presso la UOC Fisica Medica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente);
- Ing. Riccardo Salvato, in servizio presso la UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente).

Il giorno 09/07/2018 alle ore 08:50 presso i locali della UOC Fisica Medica del P.O. di Muraglia - Via Lombroso 1, si riunisce, in seduta riservata e nel plenum dei suoi componenti, la suddetta Commissione giudicatrice al fine di procedere all'assegnazione dei punteggi tecnici relativi alle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura aperta di cui in oggetto per quanto riguarda il **Lotto 1 - CT Fano**.

Ciò premesso, il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta, rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni concorrente, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.

Preliminarmente si verbalizza l'operato della Commissione nelle precedenti sedute.

sede/giorno/ora	Attività svolta
Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia  29/06/2018 9:40-12:00	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 09:40.</p> <p>Il Presidente espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, nei quali si esplicitano i Criteri di valutazione tecnici qualitativi.</p> <p>Essendo le ditte offerenti in numero superiore a due si procede alla valutazione tramite metodo del confronto a coppie. Il Presidente, pertanto, espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.</p> <p>La Commissione decide all'unanimità che, qualora nei questionari tecnici dovessero esserci delle voci non compilate o compilate in maniera parziale, si dovrà procedere ad una attenta analisi di tutta la documentazione prodotta e chiarimenti pubblicati in fase di gara al fine di verificare l'effettiva rispondenza a quanto espressamente richiesto sia come caratteristica di minima che come caratteristica preferenziale.</p> <p>Il Presidente rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica dei vari concorrenti unitamente ai chiarimenti forniti in fase di gara.</p>



	<p>Terminate le attività, la documentazione cartacea e informatizzata relativa a ciascuna offerta tecnica, viene riposta in apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia del Presidente della Commissione.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 12:00.</p>
<p>Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia</p> <p>02/07/2018 09:05-11:00</p>	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 09:05 e rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica dei vari concorrenti.</p> <p>Terminate le attività, la documentazione cartacea e informatizzata relativa a ciascuna offerta tecnica, viene riposta in apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia del Presidente della Commissione.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 11:00.</p>
<p>Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia</p> <p>03/07/2018 15:15-16:45</p>	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 15:15 e rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica dei vari concorrenti.</p> <p>Terminate le attività, la documentazione cartacea e informatizzata relativa a ciascuna offerta tecnica, viene riposta in apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia del Presidente della Commissione.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 16:45.</p>
<p>Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia</p> <p>04/07/2018 09:00-11:00</p>	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 9:00 e rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica dei vari concorrenti.</p> <p>Terminate le attività, la documentazione cartacea e informatizzata relativa a ciascuna offerta tecnica, viene riposta in apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia del Presidente della Commissione.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 11:00.</p>

Vista e richiamata l'attività di analisi ed esame svolta sulla documentazione tecnica presentata dagli operatori economici ammessi, unitamente ai chiarimenti forniti in fase di gara, la Commissione procede con l'attribuzione dei punteggi qualitativi.



Per una semplificazione dei lavori, i commissari vengono convenzionalmente indicati come rappresentato nella seguente tabella di corrispondenza:

Commissario 1	Dott.ssa Eleonora Belligotti
Commissario 2	Dr.ssa Anna Mensà
Commissario 3	Ing. Riccardo Salvato

Per ogni singolo parametro di valutazione ciascun commissario provvede alla compilazione manuale delle tabelle cartacee assegnate per il confronto a coppie.

Al termine le tabelle vengono riprodotte in un unico foglio excel. Ciascun commissario verifica la corrispondenza tra la compilazione manuale e quella elettronica e approva quest'ultima sottoscrivendone la stampa.

Tali fogli stampati e sottoscritti vengono allegati al presente verbale (Allegato n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale), mentre le tabelle compilate manualmente vengono eliminate.

Al termine di tale operazione la commissione, sempre tramite calcoli in fogli excel, provvede al calcolo dei coefficienti e alla compilazione della matrice per l'assegnazione dei punteggi tecnici secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (Allegato n.2 al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale).

La Commissione procede quindi alla compilazione del prospetto definitivo della valutazione delle offerte tecniche calcolando il Punteggio Tecnico Totale.

Terminate le attività, la documentazione relativa a ciascuna offerta tecnica viene riconsegnata al RUP.

La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere i verbali redatti e sottoscritti nell'ambito dei lavori di Commissione di cui al presente procedimento al RUP.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Elenco allegati:

*N.1 – Lotto 1 – CT Fano - Prospetti valutazione confronto a coppie: Commissario 1, Commissario 2, Commissario 3*


*N.2 - Lotto 1 – CT Fano - Prospetto finale valutazione tecnica*

Pesaro, 09/07/2018

Presidente: Dr.ssa Anna Mensà

Componente: Dott.ssa Eleonora Belligotti

Componente: Ing. Riccardo Salvato

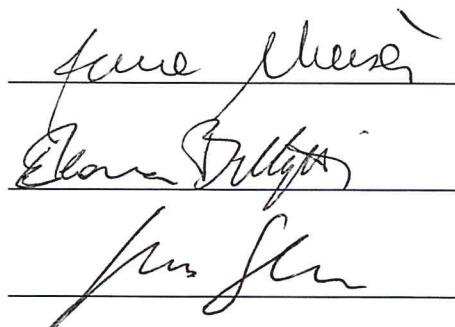



**ALLEGATO n.1 – Lotto 1 CT Fano****Prospetti valutazione confronto a coppie:  
Commissario 1, Commissario 2 e Commissario 3**

Per semplicità di lettura dei prospetti, si inseriscono le tabelle dei criteri con la relativa codifica:

<b>LOTTO 1 – PRESIDIO S.CROCE di FANO</b>		
<b>CRITERI</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>PESI</b>
<b>A</b>	Gantry, detettori, lettino	12
<b>B</b>	Tubo Radiogeno, Generatore e Consolle di comando	8
<b>C</b>	Prestazioni tomografo e sistemi riduzione della dose	13
<b>D</b>	Workstation e software di post-elaborazione	13
<b>E</b>	Accessori, Assistenza Tecnica, formazione e supporto scientifico	12
<b>F</b>	Lavori di riadattamento locali progettazione ed installazione delle tecnologie sanitarie	12
	<b>Punteggio Qualità TOTALE</b>	<b>70</b>



**COMMISSARIO 1**

<b>Criterio A</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		0	0	1
RTI GE-TELEGESTIONI	2		0	2
RTI PHILIPS-GOWEN	2	2		2
RTI SIEMENS-CECCONI	1	0	0	

<b>Criterio B</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		0	1	3
RTI GE-TELEGESTIONI	2		2	3
RTI PHILIPS-GOWEN	1	0		3
RTI SIEMENS-CECCONI	0	0	0	

<b>Criterio C</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		1	0	2
RTI GE-TELEGESTIONI	1		0	2
RTI PHILIPS-GOWEN	2	2		2
RTI SIEMENS-CECCONI	0	0	0	

<b>Criterio D</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		2	0	2
RTI GE-TELEGESTIONI	0		0	0
RTI PHILIPS-GOWEN	2	3		2
RTI SIEMENS-CECCONI	0	2	0	

<b>Criterio E</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		2	1	2
RTI GE-TELEGESTIONI	0		0	0
RTI PHILIPS-GOWEN	1	2		2
RTI SIEMENS-CECCONI	0	2	0	

<b>Criterio F</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		1	1	1
RTI GE-TELEGESTIONI	1		1	1
RTI PHILIPS-GOWEN	1	1		1
RTI SIEMENS-CECCONI	1	1	1	

**COMMISSARIO 2**

<b>Criterio A</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio B</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>4</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>3</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio C</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio D</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio E</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio F</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



**COMMISSARIO 3**

<b>Criterio A</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio B</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio C</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio D</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio E</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>Criterio F</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
RTI CANON-MORVIDUCCI		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
RTI GE-TELEGESTIONI	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
RTI PHILIPS-GOWEN	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
RTI SIEMENS-CECCONI	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	





**ALLEGATO n.2 – Lotto 1 CT Fano****Prospetto finale Valutazione Tecnica**

Per semplicità di lettura dei prospetti, si inseriscono le tabelle dei Commissari e dei criteri con la relativa codifica:

Commissario 1	Dott.ssa Eleonora Belligotti
Commissario 2	Dr.ssa Anna Mensà
Commissario 3	Ing. Riccardo Salvato

LOTTO 1 – PRESIDIO S.CROCE di FANO		
CRITERI	PARAMETRI	PESI
<b>A</b>	Gantry, detettori, lettino	12
<b>B</b>	Tubo Radiogeno, Generatore e Consolle di comando	8
<b>C</b>	Prestazioni tomografo e sistemi riduzione della dose	13
<b>D</b>	Workstation e software di post-elaborazione	13
<b>E</b>	Accessori, Assistenza Tecnica, formazione e supporto scientifico	12
<b>F</b>	Lavori di riadattamento locali progettazione ed installazione delle tecnologie sanitarie	12
	<b>Punteggio Qualità TOTALE</b>	<b>70</b>



CONFRONTE A COPPIE PROSPETTO DETERMINAZIONE COEFFICIENTI CRITERI VALUTAZIONE				
<b>Criterio A</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	5	2	0	5
Commissario 2	4	4	0	4
Commissario 3	5	1	1	5
<b>Somme parziali</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,071</b>	<b>1,000</b>
<b>Criterio B</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	3	0	3	9
Commissario 2	3	0	3	10
Commissario 3	2	2	2	9
<b>Somme parziali</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>28</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,286</b>	<b>0,071</b>	<b>0,286</b>	<b>1,000</b>
<b>Criterio C</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	3	3	0	6
Commissario 2	1	5	1	5
Commissario 3	2	5	0	5
<b>Somme parziali</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,375</b>	<b>0,813</b>	<b>0,063</b>	<b>1,000</b>
<b>Criterio D</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	2	7	0	4
Commissario 2	1	5	1	5
Commissario 3	1	5	1	5
<b>Somme parziali</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,235</b>	<b>1,000</b>	<b>0,118</b>	<b>0,824</b>
<b>Criterio E</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	1	6	1	4
Commissario 2	1	6	1	4
Commissario 3	1	5	1	5
<b>Somme parziali</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,176</b>	<b>1,000</b>	<b>0,176</b>	<b>0,765</b>
<b>Criterio F</b>	RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
Commissario 1	3	3	3	3
Commissario 2	3	3	3	3
Commissario 3	3	3	3	3
<b>Somme parziali</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>



PROSPETTO FINALE SOMME PARZIALI VALUTAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE										
	CRITERI	PESI	RTI CANON-MORVIDUCCI		RTI GE-TELEGESTIONI		RTI PHILIPS-GOWEN		RTI SIEMENS-CECCONI	
			Coeff.	Punti	Coeff.	Punti	Coeff.	Punti	Coeff.	Punti
CONFRONTO A COPPIE	A	12	1,000	12,000	0,500	6,000	0,071	0,857	1,000	12,000
	B	8	0,286	2,286	0,071	0,571	0,286	2,286	1,000	8,000
	C	13	0,375	4,875	0,813	10,563	0,063	0,813	1,000	13,000
	D	13	0,235	3,059	1,000	13,000	0,118	1,529	0,824	10,706
	E	12	0,176	2,118	1,000	12,000	0,176	2,118	0,765	9,176
	F	12	1,000	12,000	1,000	12,000	1,000	12,000	1,000	12,000

		RTI CANON-MORVIDUCCI	RTI GE-TELEGESTIONI	RTI PHILIPS-GOWEN	RTI SIEMENS-CECCONI
PUNTEGGIO TECNICO	70,000	36,337	54,134	19,602	64,882